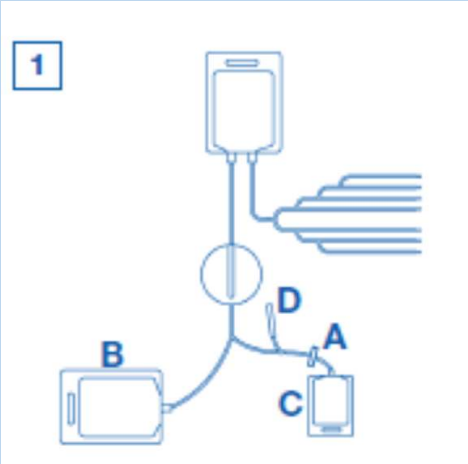


Charakteristika	Technické požadavky	ANO/NE	poznámky/skutečné parametry včetně uvedení jednotek
Systém filtrační pro odstranění leukocytů ze směsi jednotek trombocytů z Buffy Coatu, ("chobotnice"), předpokládáný počet kusů jednotlivých systémů 3000/3roky	filtrační systém musí být určen k jednorázovému použití		
Ilustrativní vyobrazení 	filtrační systém musí být určen k odstraňování leukocytů a mikroagregátů ze směsi jednotek trombocytů z buffy coatu v průběhu zpracování		
	filtrační systém musí být určen pro in-line filtraci až 6ti "poolovaných" buffy coatů		
	souprava musí obsahovat systém minimálně 7 hadiček pro napojení buffy coatů (max.6) a 1 promývacího roztoku, souprava musí obsahovat sběrný vak pro poolování všech buffy coatů a promývacího roztoku, centrifugace meziprodktu musí probíhat ve sběrném vaku, souprava musí obsahovat filtrační systém pro odstranění leukocytů, souprava musí obsahovat transfer vak vhodný k uskladnění trombocytů, u transfer vaku s trombocyty musí být vzorkovací váček. Schéma požadované soupravy viz příložené Ilustrativní vyobrazení		
	souprava musí obsahovat transfer vak vhodný k uskladnění trombocytů při teplotě 22±2°C po dobu maximálně 5 dnů na agitátoru		
	souprava musí umožnit poolování buffy coatů ve sběrném vaku ne v jednom z původních vaků buffy coatu		
	filtrační systém musí umožnit velmi jednoduchou manipulaci		
	filtrační systém musí umožnit krátký čas filtrace, čas filtrace může být maximálně 10 minut		
	filtrační systém musí mít vysokou účinnost deleukotizace s reziduálním počtem leukocytů nižším než 2x10 ⁵		
	filtrační systém musí zajistit filtraci s vysokou hladinou zachovaných trombocytů, filtrační ztráta < 5 %		
	filtrační systém musí umožnit rychlé automatické plnění filtru na počátku filtrace bez nutnosti promývání fyziologickým roztokem		
	filtrační systém musí zajistit 100% záchyt CMV		
	filtrační systém musí umožnit automatické zastavení filtrace při kontaktu s RBC		
	filtrační systém musí mít jako filtrační medium membránu zabraňující jakémukoli uvolnění leukocytů		
	materiál filtračního systému musí být bez přírodního latexu		
	vyrobené trombocyty musí splňovat legislativní jakostní požadavky na trombocyty z buffy coatu směsné deleukotizované resuspendované		
	souprava se systémem hadiček musí umožnit spojování hadiček sterilní svářečkou		
	souprava vaků a hadiček musí být sterilní a nepyrogeenní k přenosu kapalin		
	kvalita soupravy vaků s hadičkami a filtrem musí být individuálně kontrolována v souladu s mezinárodními standardy		
	zkušební provoz a validace musí být v ceně nabídky - 20 vaků		
	souprava vaků s hadičkami a filtrem musí být sterilně balena po jednom kuse s příbalovým letákem a certifikátem od výrobce o kontrole kvality		
	materiál soupravy vaků s hadičkami a filtrem musí být v souladu s platnou legislativou ČR		
	Další podmínky		
	poštovné a balné v ceně		
	expirace 12 měsíců		
	CE značka		
	prohlášení o shodě		
	poskytnutí vzorků k ověření kvality materiálu - na vyžádání		

Poznámka:

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.